



한국원자력의학원


수신자 병원장
(경유) 품질관리전문인
제목 RG 장비 독립적 품질감사 서비스 관련 협조 요청

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 한국원자력의학원의 국제공인교정기관은 원자력안전위원회 고시 제2019-6호(의료분야의 방사선 안전관리에 관한 기술기준)에 따라 RG 장비에 대한 독립적 품질감사 서비스를 제공하고 있습니다.
3. 이와 관련하여 2022년 RG 장비에 따른 독립적 품질감사 서비스 비용을 공지하고자 하오니 협조 요청드립니다.

가. 독립적 품질감사 비용

항목	선형가속기	토모테라피	사이버나이프
검사 항목	출력선량 및 기계적 정확도	출력선량 및 기계적 정확도	출력선량 및 기계적 정확도
기본 비용	150만원/대 (광자 2개, 전자선 5개)	100만원/대 (광자 1개)	100만원/대 (광자 1개)
추가 비용	출력선량: 200,000원/빔질 기계적 정확도: 500,000원/장비		

4. 문의는 한국원자력의학원 KOLAS 국제공인교정기관 품질책임자 김금배 (010-5038-2278, kbkim@kirams.re.kr) 혹은 기술책임자 최상현 (010-2631-2198, shchoi@kirams.re.kr) 으로 해주시기 바랍니다. 끝.

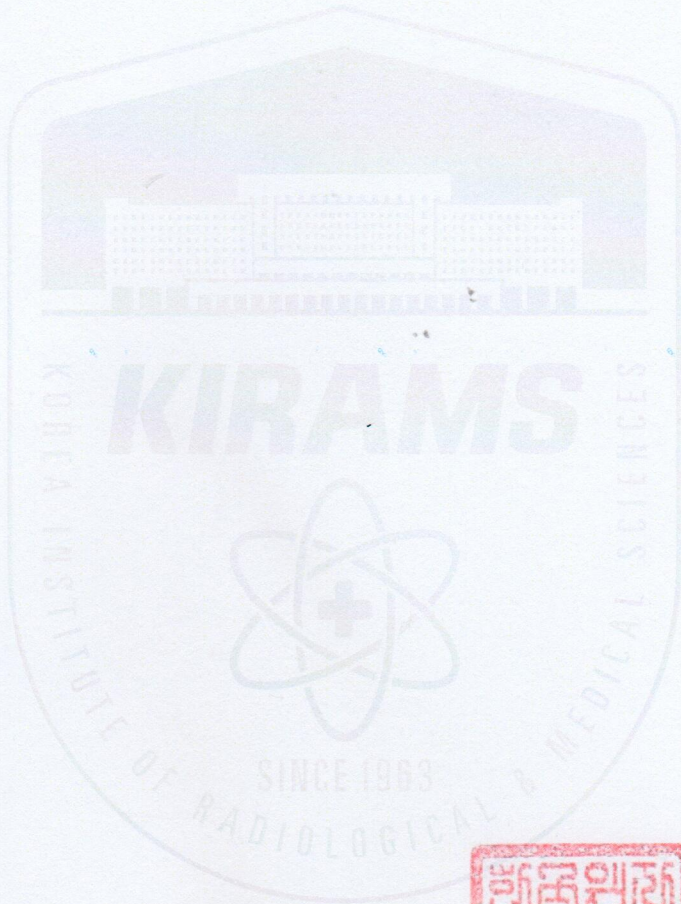

의학물리공학연구팀장



선임연구원 조규석 팀장 전결 09/21 김금배

협조자

시행 의학물리공학연구팀 (2022. 10. 11.) 접수 -1813

우 01812 서울특별시 노원구 노원로 75 (공릉동) / <http://www.kirams.re.kr>

전화 02-970-1656 전송 02)978-2005 / gscho1752@kirams.re.kr / 대국민공개

개인정보보호는 선택이 아닌 필수입니다.